

Modelleinlage

- Indikationen:

Sekundäre Fehlstellungen im Vorfußbereich

Kontrakter Knick-Senk(Platt)fuß

Hohlfuß (kontrakt)

Klumpfuß

Sichelfuß (kontrakt)

Fersenbeinbruch

Rheumatisch bedingte Fußdeformitäten,

etc.

Grundlage für Modelleinlagenfertigung

- Diagnose lt. Verordnungssche
- Fußuntersuchung mit der Har


VERORDNUNGSSCHEIN FÜR HEILBEHELFE, HILFSMITTEL UND SPRACHBEHANDLUNG		Verordnungs- nummer		Reg. Nr.	
3032463					
Patientennummer		Vorname		Diagnose	
[REDACTED]		[REDACTED]		Metatarsalgie bds	
Verordnung		Artikel-Nr.		10.09.2004	
1 Paar Einlagen nach Modell mit Metatarsal retrocarale 2 bis 4 und Wölbung MTK II u. III bds		Ein gültiger Krankenschein		[REDACTED]	
Bezugsanweisung der Klasse für 14 Tage gültig		Tarif		72,-	
Pensionistin		Befürwortung d. VbG, Gebietskrankenkasse		zusätzlich 20% MWST	
Art.-Nr. 1412100		Art.-Nr. 1412100		Tarif (Arbeits)	
				86,40	
				Art.-Nr. (Arbeits)	
				231,- mind. 20%	
				Art.-Nr. (Arbeits)	
				65,80	
				Art.-Nr. (Arbeits)	
				19. Okt. 2004 abgibt	
21.9.04		Marianella Ruan		[REDACTED]	

fühlen
tasten
spüren
fragen



Grundlage für Modelleinlagenfertigung

- Trittspur

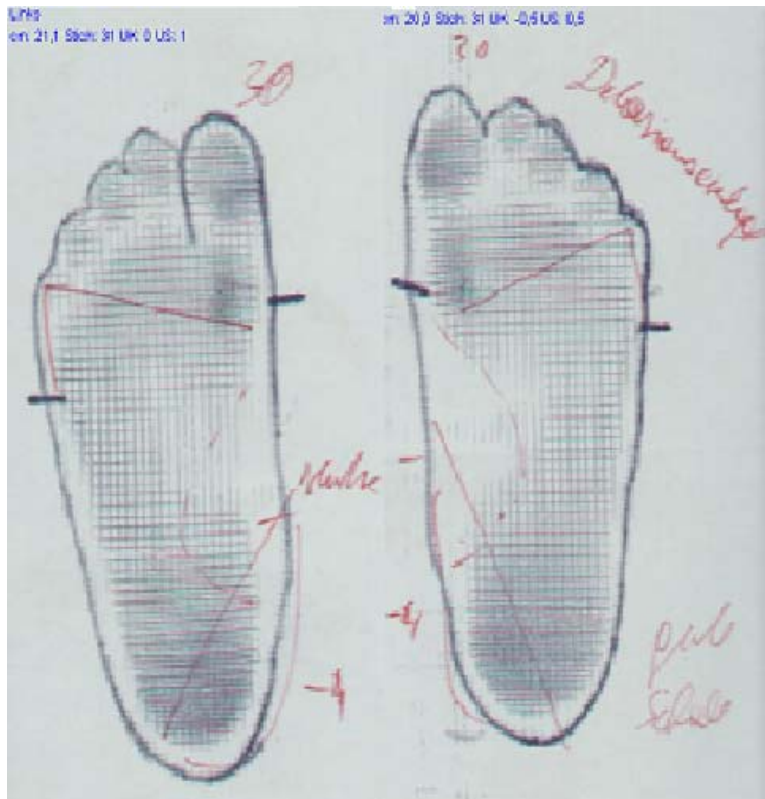


Grundlage für Modelleinlagenfertigung

- Abdruckform







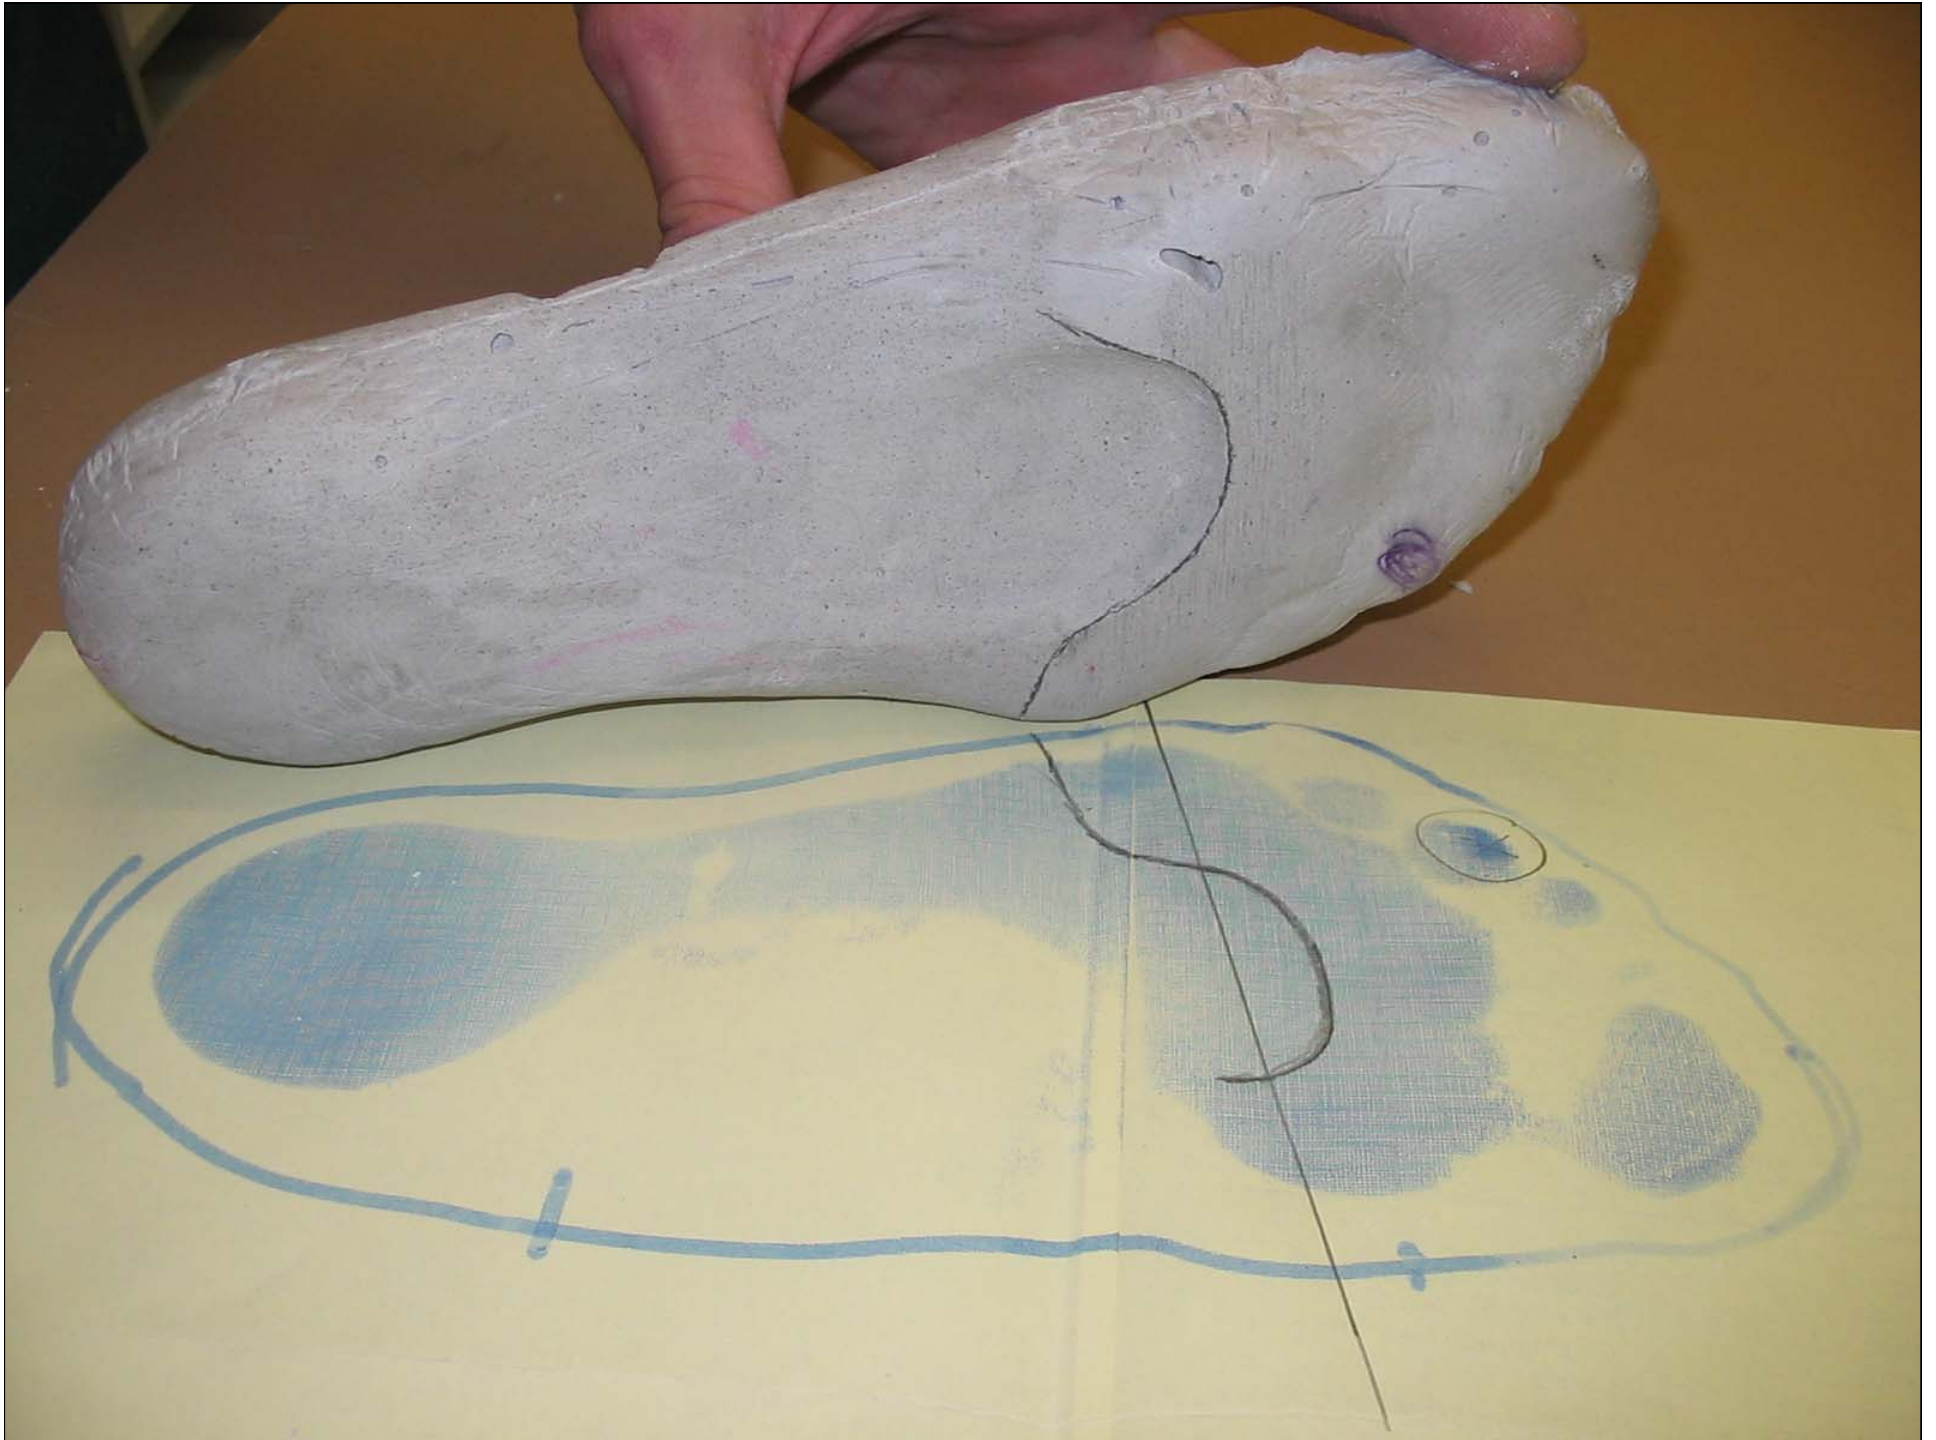











Bitte die selbstschmierenden Muttern auf dem Rahmen NICHT versetzen, da dadurch eine genaue Funktion verloren geht!

Bei Verwendung feuchter Materialien oder Modelle unbedingt Pumpe nachlaufen lassen!
Siehe Bedienungsanleitung Seite 23!

